

서울아산청라병원 응급용 옥상 헬기장 설치계획 알립니다.

설치 목적

- 응급환자를 신속하게 이송하여 치료 시간을 단축하고 국민의 생명을 보호합니다.
- 의료 취약지역에서 응급환자의 이송 체계를 강화해 인천 지역의 응급의료 서비스 수준을 향상시킵니다.
- 인천 지역의 긴급구조활동대응 등 공공복지 증진을 도모합니다.(긴급 이송 시 소음이 발생할 수 있음.)


“응급환자를 병원으로 이송하는 하늘을 나는 구급차, 응급헬기”

응급헬기 소리는 한 사람의 소중한 생명을 구하는 희망의 소리입니다.


▶ 서울아산청라병원 위치안내도 (2029년 준공, 2030년 개원 예정)



▶ 서울아산청라병원 응급용 옥상헬기장 설치계획도

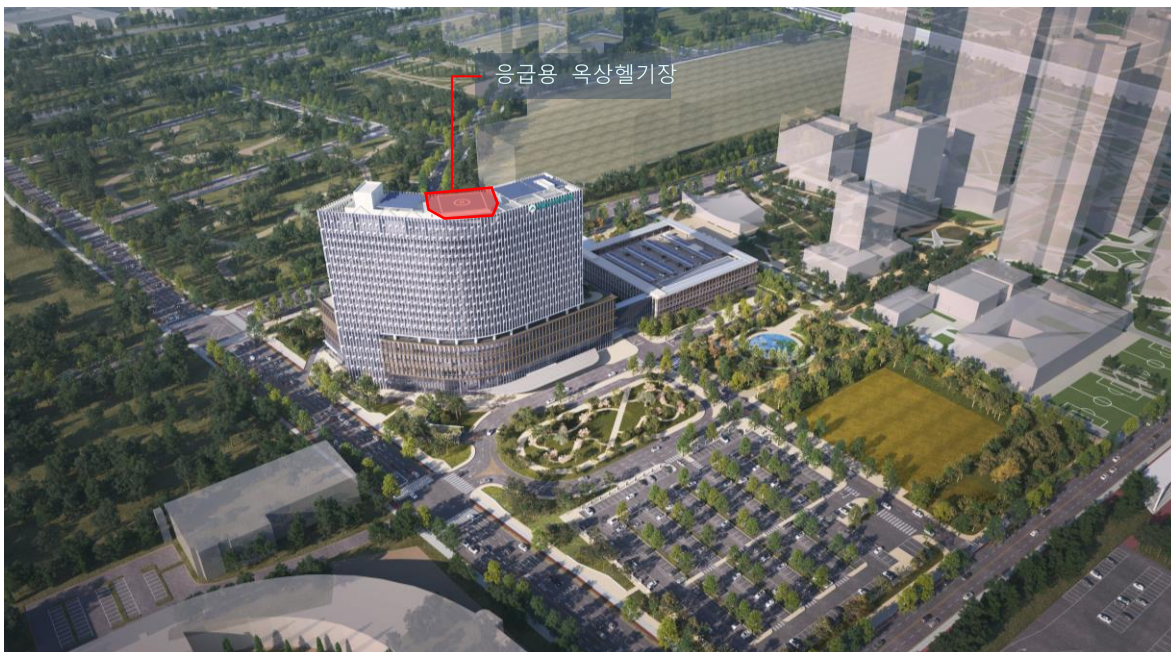

〈서울아산청라병원 응급용 옥상 헬기장 소음 예상수치〉

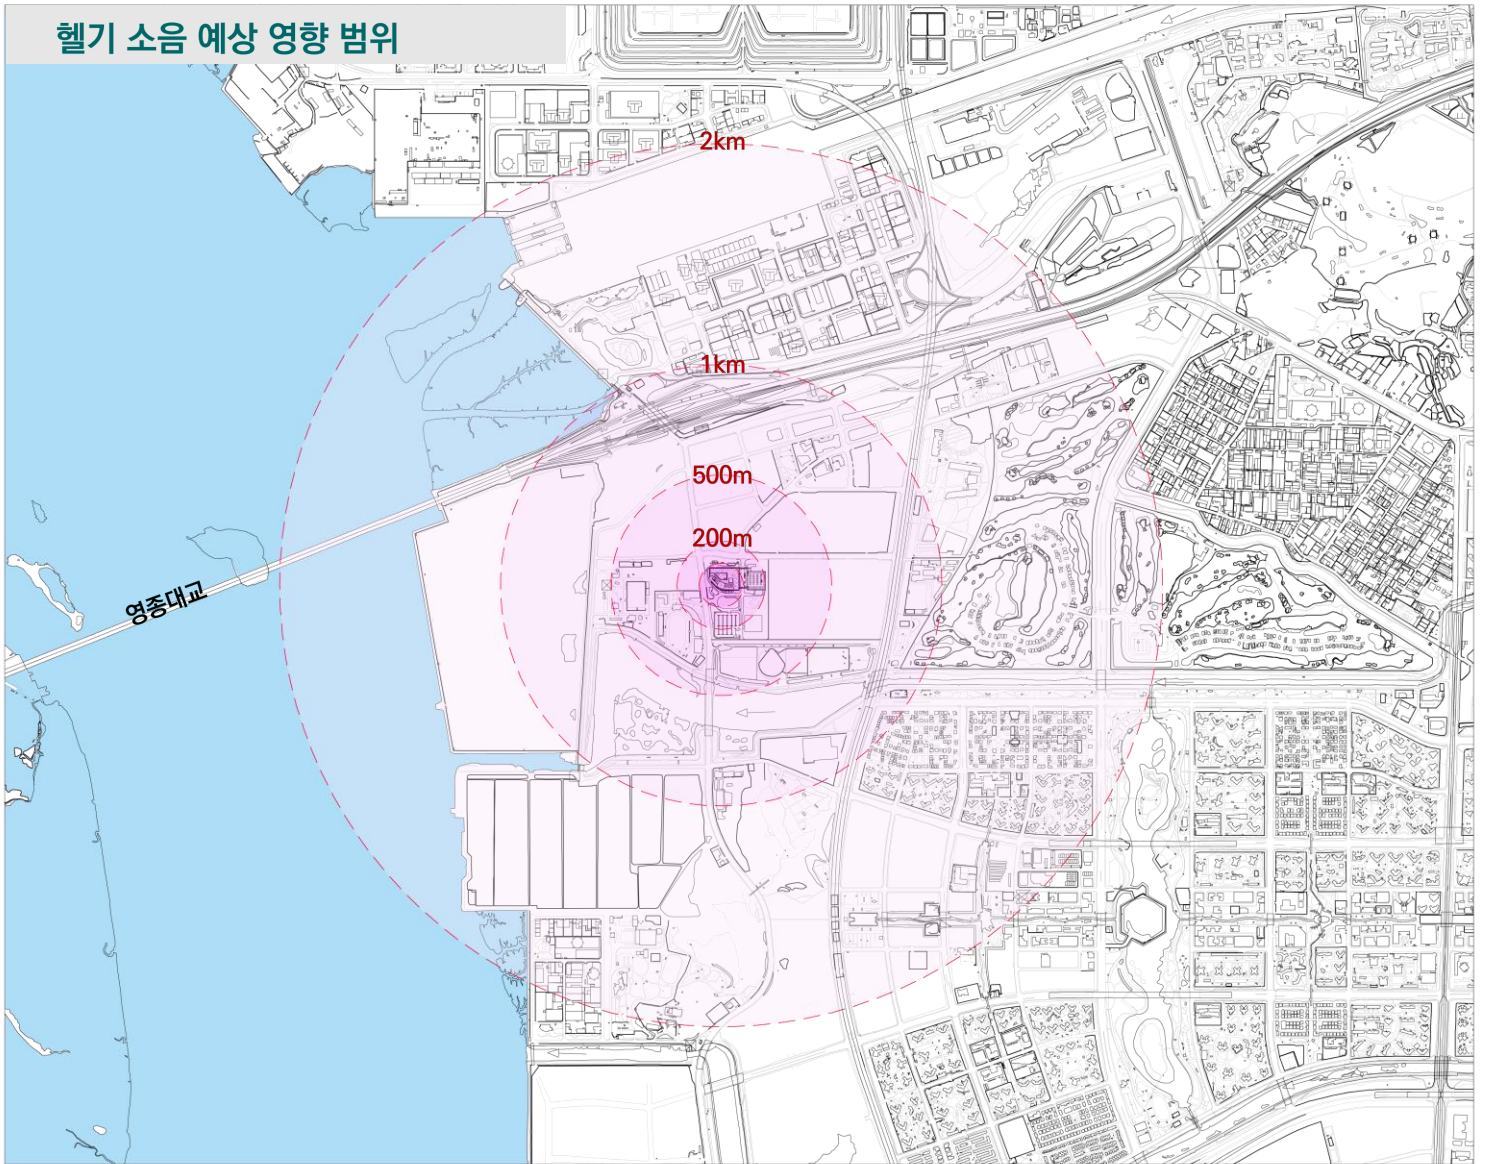

■ 헬기 이착륙 시 예상 소음

- ~ 200m : 전화통화나 대화에 지장을 주는 수준, 창문을 닫아도 소음 체감 가능
- ~ 500m : 소음이 분명히 들리지만 일상생활은 가능
- ~ 1km : 실외에서는 이착륙 소리 인지 가능, 창문을 닫은 실내에서는 거의 신경 쓰이지 않는 수준
- ~ 2km : 일상생활에 거의 지장을 주지 않는 수치

사용예정 항공기 기종 : EC-135

- 응급의료헬기, 경찰헬기 등으로 널리 사용되는 기종
- 동급 헬기 중 가장 조용한 저소음 기술이 적용된 기종

